

α -淀粉酶检测试剂盒（微量法）

货号：PMK1155

保存：4℃保存 12 个月

规格：48T/96T

检测范围：0.0156-1mg/mL（标准品的检测范围，需要根据样本情况折算为活性的检测范围）

灵敏度：0.0078mg/mL（标准品的灵敏度，需要根据样本情况折算为活性的灵敏度）

适用样本：血清（浆）、唾液、动物组织、植物组织（种子或新萌发幼苗）

产品简介

淀粉酶负责水解淀粉，包括 α -淀粉酶（ α -AL，EC 3.2.1.1）和 β -淀粉酶（ β -AL）。 α -淀粉酶随机催化淀粉中 α -1,4-糖苷键水解，生成葡萄糖、麦芽糖、麦芽三糖、糊精等还原糖，同时使淀粉的粘度降低，因此又称为液化酶。 α -淀粉酶分布十分广泛，遍及微生物乃至高等植物。本试剂盒提供了一种简单的比色法来检测生物样本中 α -淀粉酶活性，其原理是淀粉水解酶催化淀粉水解生成还原糖，还原糖还原 3,5-二硝基水杨酸生成棕红色物质，在 540nm 有吸收峰；通过测定 540nm 吸光度增加速率，计算淀粉酶活性。 α -淀粉酶耐热，但是 β -淀粉酶在 70℃下 15min 可钝化。因此粗酶液经过 70℃钝化 15min，就只有 α -淀粉酶能够催化淀粉水解。

产品内容

试剂盒组分	规格		储存条件
	48T	96T	
DNS 试剂	20mL	40mL	室温避光保存
底物	1	1	4℃
标准品	1	1	4℃

自备耗材

酶标仪或可见光分光光度计（能测 540nm 处的吸光度）

水浴锅、离心机

96 孔板或微量玻璃比色皿、可调节式移液枪及枪头

去离子水

匀浆器（如果是组织样本）

试剂准备

注意：各组分（小管试剂）开盖前，请先低速离心。

DNS 试剂：常温保存，若有黄色晶体析出，需 90℃加热溶解后再用。

底物：临用前 96T 加入 20 mL 去离子水，48T 加入 10 mL 去离子水，上下颠倒摇晃几次，加热至溶解。溶解后的底物 4℃保存，若有沉淀析出，可 70℃加热溶解后使用。

标准品：含 10 mg 无水葡萄糖，临用前加入 1mL 去离子水溶解得 10 mg/mL 标准品。溶解后的标准品可 4℃保存 1 个月或-20℃长期保存。

标准曲线设置：按下表所示，用去离子水将 10 mg/mL 标准品稀释为 1、0.5、0.25、0.125、0.0625、0.0313、0.0156 mg/mL 的标准溶液。

	标准品体积 (μ L)	去离子水体积 (μ L)	标准品浓度 (mg/mL)
标准品 1	40 μ L 10mg/mL	360	1

产品说明书

标准品 2	200 μ L of 标准品 1 (1mg/mL)	200	0.5
标准品 3	200 μ L of 标准品 2 (0.5mg/mL)	200	0.25
标准品 4	200 μ L of 标准品 3 (0.25mg/mL)	200	0.125
标准品 5	200 μ L of 标准品 4 (0.125mg/mL)	200	0.0625
标准品 6	200 μ L of 标准品 5 (0.0625mg/mL)	200	0.0313
标准品 7	200 μ L of 标准品 6 (0.0313mg/mL)	200	0.0156

注意：每次实验，请使用新配制的标准品。

样本制备

注意：

1. 动物组织：称取约 0.1g 样本，加入 1mL 去离子水匀浆，将匀浆倒入离心管中，在室温下放置 15min，每隔 5min 振荡 1 次，使其充分提取。6,000g，室温离心 10min，吸取上清液并且加去离子水定容至 10mL，摇匀，即为淀粉酶原液。
2. 植物组织：称取约 0.1g 样本，加入 1mL 去离子水捣碎，超声波破碎 5min（功率 20%，超声 3s，间隔 7s，重复 30 次），在室温下放置 15min，每隔 5min 振荡 1 次，使其充分提取。6,000g，室温离心 10min，吸取上清液并且加去离子水定容至 10mL，摇匀，即为淀粉酶原液。
3. 血清（浆）和唾液等液体样本：直接测定。建议预实验确定合适的稀释倍数。

注意：推荐使用新鲜样本，如果不立即进行实验，样本可在-80℃保存 6 个月。对于脂肪含量较高的动物组织，离心后移除上层脂肪，再取上清液。如需测定蛋白浓度，推荐使用 BCA 法蛋白质定量试剂盒进行样本蛋白质浓度测定。

实验步骤

1. 酶标仪或可见光分光光度计预热 30min 以上，调节波长到 540nm，可见光分光光度计去离子水调零。
2. 水浴锅预热到 70℃。
3. 取 75 μ L 样本沸水浴 5min 作为对照管使用。
4. 样本测定（在 EP 管中依次加入下列试剂）：

试剂名称	空白管（ μ L）	标准管（ μ L）	测定管（ μ L）	对照管（ μ L）
去离子水	75	0	0	
不同浓度标准品	0	75	0	
样本	0	0	75	75（煮沸样本）

70℃水浴 15min，冷却

底物	0	0	75	0
去离子水	75	75	0	0

40℃恒温水浴中保温 5min

DNS 试剂	150	150	150	150
底物	0	0	0	75

5. 混匀，沸水浴 5min，冷却，取 200 μ L 至 96 孔板或微量玻璃比色皿中，测定 540nm 处的吸光值，计算 ΔA
 $\Delta A_{\text{测定}} = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ ； $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}$ 。

注意：每个样本需设置一个对照管，空白管只需做 1 管。实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本 $A_{\text{测定}}$ 大于 2，则说明样本酶活力太高，必须用去离子水稀释成适当浓度（计算公式中乘以相应稀释倍数）。若 $\Delta A_{\text{测定}}$ 小于 0.005 可以重新提取样本减少去离子水定容的体积。

产品说明书

结果计算

1. 标准曲线的绘制

以标准液浓度为 y 轴， $\Delta A_{\text{标准}}$ 为 x 轴，绘制标准曲线。将 $\Delta A_{\text{测定}}$ 带入方程得到 y 值 (mg/mL)。

2. α -淀粉酶活性计算

(1) 按样本鲜重计算

单位定义：每 g 组织在反应体系中每分钟催化产生 1mg 还原糖定义为 1 个酶活力单位。

$$\alpha\text{-淀粉酶活性 (U/g 质量)} = y \times V_{\text{反应}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T \times n = 4 \times y \div W \times n$$

(2) 按样本蛋白浓度计算

单位的定义：每 mg 组织蛋白在反应体系中每分钟产生 1mg 还原糖定义为 1 个酶活力单位。

$$\alpha\text{-淀粉酶活性 (U/mg prot)} = y \times V_{\text{反应}} \div (Cpr \times V_{\text{样}}) \div T \times n = 0.4 \times y \div Cpr \times n$$

(3) 按液体样本体积计算


单位的定义：每毫升液体样本在反应体系中每分钟产生 1mg 还原糖定义为 1 个酶活力单位。

$$\alpha\text{-淀粉酶活性 (U/mL)} = y \times V_{\text{反应}} \div V_{\text{样}} \div T \times n = 0.4 \times y \times n$$

$V_{\text{反应}}$: 反应体系总体积, 0.15mL; $V_{\text{样}}$: 加入反应体系中样本体积, 0.075mL; W: 样本质量, g; $V_{\text{样总}}$: 样本总体积, 10mL; T: 反应时间, 5min; n: 样本稀释倍数; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL。

结果展示

典型标准曲线-以下数据和曲线仅供参考，实验者需根据自己的实验建立标准曲线。

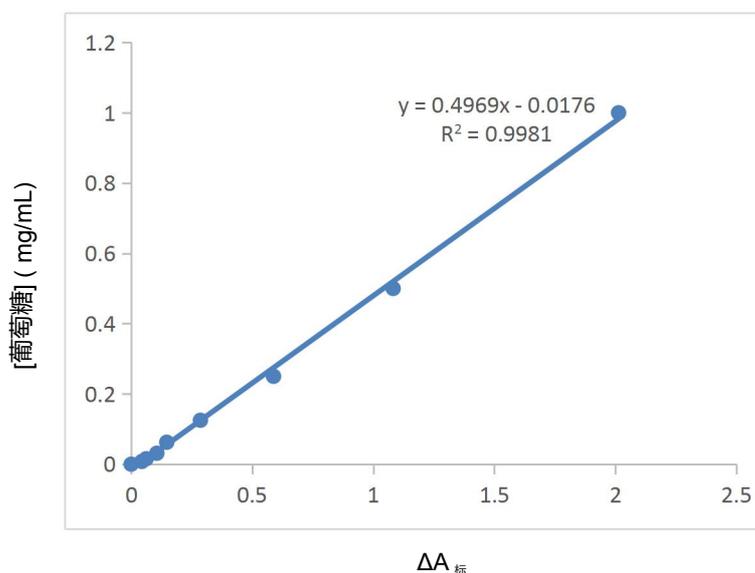

注意事项

1. 实验过程中请穿戴实验服、口罩和乳胶手套。请按照生物实验室的国家安全规定进行实验，尤其是在检测血样或其他体液时。
2. 本试剂盒仅用于实验室科学研究，如果本试剂盒用于临床诊断或任何其他用途，我们将不对任何后果负责。
3. 本试剂盒应在有效期内使用，并请严格按照说明书进行存储。
4. 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用；否则，可能导致结果异常。
5. 勤换吸头，避免各组分之间的交叉污染。

相关产品：

PMK1156 β -淀粉酶检测试剂盒（微量法）

PMK1160 淀粉分支酶（SBE）检测试剂盒（微量法）

PMK1164 葡萄糖检测试剂盒（微量法）

更多产品详情了解，请关注公众号：

