

人血小板因子 4 (PF4) ELISA 试剂盒

货号: PMK1409ES

保存: 2-8℃避光保存 6 个月

规格: 48T/96T

检测范围: 0.63-40ng/mL 灵敏度: 0.38ng/mL

精密性: 板内变异系数<10%, 板间变异系数<10%

回收率范围: 80-120%

特异性: 检测具有高灵敏度和优良的特异性。未观察到和人血小板因子 4 (PF4) 类似物之间的显著交叉反应或干扰。

适用样本: 血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清和其他生物体液

检测原理

该试剂盒采用双抗夹心酶联免疫吸附法原理。酶标板预包被亲和纯化的抗人 PF4 的抗体。将含有人 PF4 的样品或标准品加入到酶标板中, 与包被抗体反应。再加入生物素标记的检测抗体, 并与酶标板上捕获的人 PF4 结合。接着, 加入链霉亲和素-辣根过氧化物酶 (SA-HRP) 以形成固相抗体-人 PF4-生物素标记抗体-SA-HRP 的夹心复合物。然后, 将 TMB 溶液加入孔中并进行孵育, 酶促反应产生蓝色物质, 加入终止液后, 变成黄色。在 450nm 波长下测定吸光值。最后通过建立标准曲线, 根据 OD 值来计算样品中人 PF4 的浓度。

包装清单

未拆封的试剂盒可在 2-8℃保存 6 个月; 如果开封使用后, 请按照下表中的条件分别保存各组分。

试剂盒组分	规格		储存条件
	48T	96T	
预包被微孔板	48 孔	96 孔	-20℃
标准品	冻干粉, 1 支	冻干粉, 2 支	-20℃
检测试剂 A(生物素化抗体 100×)	60 μL	120 μL	-20℃
检测试剂 B(SA-HRP 酶结合物 100×)	60 μL	120 μL	-20℃
标准品/样品稀释液	10mL	20mL	2-8℃
检测试剂 A 稀释液	6.5mL	13mL	2-8℃
检测试剂 B 稀释液	6.5mL	13mL	2-8℃
洗涤液 (25×)	15mL	30mL	2-8℃
底物溶液 (TMB)	5mL	10mL	2-8℃避光保存
终止液	5mL	10mL	2-8℃
封板膜	2 张	4 张	室温
说明书	1 份	1 份	室温

自备耗材

酶标仪 (能测 450nm 处的吸光度)

多通道移液器或自动洗板机

恒温箱、低温离心机

可调节式移液枪及枪头

去离子水

产品说明书

试剂准备

注意：各组分（小管试剂）开盖前，请先低速离心。

1. 使用前将所有试剂平衡至室温 (18–25℃)。按照酶标仪说明书进行设置检测波长为 450nm，并在读板前预热 15 分钟。
2. 洗涤液：取浓缩洗涤液，根据检测数量，用去离子水或蒸馏水 1：24 稀释，混匀后备用。
3. 检测试剂 A 工作液：实验前计算所需量 (100 μ L/孔)。在准备工作中，应该准备比计算量稍微多一点（多 100–200 μ L）。使用前将原液管离心，用检测试剂 A 稀释液将 100 $\times$ 浓缩检测试剂 A 稀释至 1 $\times$ 工作液（如：10 μ L 检测试剂 A + 990 μ L 检测试剂 A 稀释液）。
4. 检测试剂 B 工作液：实验前计算所需量 (100 μ L/孔)。在准备工作中，应该准备比计算量稍微多一点（多 100–200 μ L）。使用前将原液管离心，用检测试剂 B 稀释液将 100 $\times$ 浓缩检测试剂 B 稀释至 1 $\times$ 工作液（如：10 μ L 检测试剂 B + 990 μ L 检测试剂 B 稀释液）。
5. 标准工作液：首先，标准品 10000 $\times$ g 离心 1min，加入 1mL 标准品/样品稀释液，使其静止 10min 再轻柔混匀，这就是 40ng/mL 工作储备液，然后取 7 个 EP 管，每管内加入 500 μ L 标准品/样品稀释液。吸取 500 μ L 40ng/mL 标准品稀释液到第一个管内再混匀即为 20ng/mL 工作液。按照下表将 500 μ L 的溶液从前管移到后管中。在下次转移前，将每管彻底混匀。设定 7 个梯度稀释标准品如 40ng/mL, 20ng/mL, 10ng/mL, 5 ng/mL, 2.5ng/mL, 1.25ng/mL, 0.63ng/mL，最后 1 个装有标准品/样品稀释液的 EP 管是空白对照作为 0ng/mL。

	标准品体积	标准品/样品稀释液 体积 (μ L)	标准品浓度 (ng/mL)
Std. 1	1000 μ L 40ng/mL	0	40
Std. 2	500 μ L of Std. 1 (40ng/mL)	500	20
Std. 3	500 μ L of Std. 2 (20ng/mL)	500	10
Std. 4	500 μ L of Std. 3 (10ng/mL)	500	5
Std. 5	500 μ L of Std. 4 (5ng/mL)	500	2.5
Std. 6	500 μ L of Std. 5 (2.5ng/mL)	500	1.25
Std. 7	500 μ L of Std. 6 (1.25ng/mL)	500	0.63
Blank	0	500	0

注意：每次实验，请使用新配制的标准品，工作储备液可 2–8℃保存一周。

样品收集

血清：让血样在室温下凝结 2 小时或在 2–8℃下过夜，然后在 2–8℃下 2000 $\times$ g 离心 15 分钟。随后立即取上清液进行检测，或存储在–20℃或–80℃备用。

血浆：使用 EDTA 或肝素作为抗凝剂收集血浆。采集后 30 分钟内，在 2–8℃, 2000 $\times$ g 条件下离心样品 15 分钟，随后立即取上清液进行检测，或存储在–20℃或–80℃下备用。

组织匀浆：应在预冷的 PBS 中冲洗组织，彻底清除多余的血液，称重，切成小块。然后在冰上的采用玻璃匀质器在 PBS（组织重量 (g)：PBS (mL) 体积=1：9）中均质化组织块。使用超声波细胞破碎机对所得匀质悬浮液进行超声处理，直到溶液澄清。然后将匀浆在 10000 $\times$ g 下离心 5 分钟。随后立即取上清液进行检测，或存储在–20℃或–80℃下备用。

细胞裂解物：对于粘附细胞，用适量预冷的 PBS 轻轻清洗细胞，并用胰蛋白酶分离细胞。以 1000 $\times$ g 离心 5 分钟收集细胞（悬浮细胞可直接离心收集）。弃上清，用冷 PBS 清洗细胞 3 次。以浓度为 5×10^6 个细胞/1mL 预冷 PBS 重新悬浮细胞。重复冻融数次，直到细胞完全溶解。1500 $\times$ g, 2–8℃离心 10min。随后立即取上清液进行检测，或存储在–20℃或–80℃下备用。

细胞培养上清和其他生物体液：在 1500 $\times$ g, 2–8℃条件下离心样品 15 分钟。随后立即取上清液进行检测，或存储在–20℃或–80℃下备用。

注意：不要使用严重溶血或脂血的标本。如果样品要在 6 天内使用，则可以将其储存在 2–8℃，长期保存需分装存储在–20℃或–80℃，避免反复冻融。测定前，应将冷冻样品缓慢升至室温并轻轻混合。实验之前建议

产品说明书

选择 2-3 个预期差异大的样本用标准品/样品稀释液稀释几个不同倍数做预实验确定合适的稀释倍数，计算结果乘以稀释倍数。

实验步骤


1. 从板框上取下待用的微孔板条，将剩余的板条放回装有干燥剂的铝箔袋中，然后重新密封保存。
2. 分别设定标准孔、空白孔和样本孔。标准孔加入 100 μ L 倍比稀释的标准品，空白孔加入 100 μ L 标准品/样品稀释液，其余孔加入 100 μ L 待测样本(建议所有的待检样本和标准品在检测中设立复孔；建议通过预实验或咨询技术支持确定待检样本的稀释倍数)。给酶标板覆膜，37 $^{\circ}$ C 孵育 90 分钟。提示：加样时将样品加于酶标板底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀，避免产生气泡。加样时间宜控制在 10 分钟内。
3. 甩尽孔内液体，洗涤 3 次。每个孔中加入检测试剂 A 工作液 100 μ L，酶标板加上新覆膜，37 $^{\circ}$ C 温育 60 分钟。
4. 甩尽孔内液体，在洁净的吸水纸上拍干。每孔加洗涤液 300 μ L，浸泡 30 秒，吸去或甩掉酶标板内的液体，拍干。重复此洗板步骤 3 次。
提示：此处与其他洗板步骤都可使用洗板机(参考北京拓普 DEM-3 型洗板机参数设置：2 点吸，每孔加入洗涤液 300 μ L，振板 5 秒，吸液 0.5 秒)。洗板完成后请立即进行下步操作，不要让微孔板干燥。
5. 每孔加检测试剂 B 工作液 100 μ L，酶标板加上覆膜，37 $^{\circ}$ C 温育 30 分钟。
6. 甩尽孔内液体，洗板 3 次，方法同步骤 4。
7. 每孔加底物溶液 (TMB) 100 μ L，酶标板加上覆膜，37 $^{\circ}$ C 避光孵育 15 分钟左右。提示：根据实际显色情况酌情缩短或延长，但不可超过 30 分钟。当标准孔出现明显梯度时(前 4 个显色孔出现明显蓝色梯度)，即可终止。提前 15 分钟打开酶标仪预热。
8. 每孔加终止液 50 μ L，终止反应。提示：终止液的加入顺序应尽量与底物溶液的加入顺序相同。
9. 立即用酶标仪在 5 分钟内测定每个孔 450nm 的光密度(OD 值)。如果可以选择校正波长，则设置为 630 nm 或 570 nm。并从 450 nm 的读数中减去 630 nm 或 570 nm 的读数，这种方式可以校正并去除非显色物质的 OD 值，从而获得更准确的检测结果。如果无法选择校正波长，则获得的读数将偏高，导致读数的准确度下降。

计算

每个标准品和样品的重复读数分别取平均值，然后减去零孔 OD 的平均值。以 x 轴为 OD 值，y 轴为标准品浓度。拟合一条标准曲线，将样本减去零孔后的 OD 值作为 x 带入计算 y (浓度)。如果样品被稀释，从标准曲线上读出的浓度必须乘以稀释系数。

结果展示

典型标准曲线 ($R^2 \geq 0.99$)

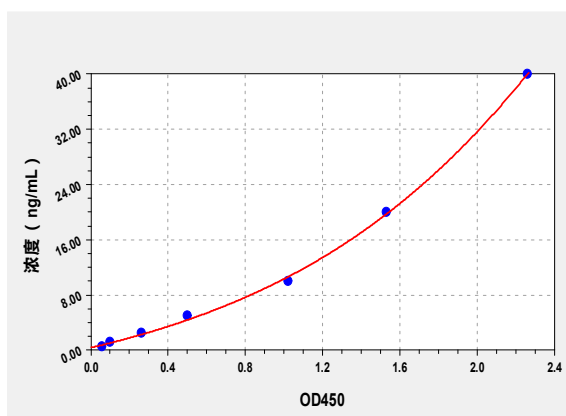

人血小板因子 4(PF4) 标准曲线。数据和曲线仅供参考，实验者需根据自己的实验建立标准曲线

注意事项

1. 实验过程中请穿戴实验服、口罩和乳胶手套。请按照生物实验室的国家安全规定进行实验，尤其是在检测血样或其他体液时。终止液有一定的腐蚀性，操作时请做好防护措施。
2. 本试剂盒仅用于实验室科学研究，如果本试剂盒用于临床诊断或任何其他用途，我们将不对任何后果负责。

产品说明书

3. 本试剂盒应在有效期内使用，并请严格按照说明书进行存储。收到试剂盒后，未开封的试剂盒可在 2-8℃ 下保存 1 个月。如果试剂盒在 1 个月内不使用，请在收到试剂盒后，将每个组件分别存放在上表中指示的温度下。
4. 新打开的 ELISA 酶标板可能含有水雾样物质，此为正常现象，不会对实验结果产生任何影响。未用完的板条应立即放回装有干燥剂的铝箔袋中，重新密封并在 -20℃ 下存储。
5. 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用；否则，可能导致结果异常。
6. 勤换吸头，避免各组分之间的交叉污染。
7. 溶解含有蛋白质溶液时，应始终避免起泡。
8. 不得重复使用稀释后的工作液。
9. 为了得到准确的实验结果，在孵育过程中，必须确保封板膜将酶标板密封。
10. 在使用自动洗板机时，添加清洗缓冲液后，在清洗步骤之间添加 30 秒的浸泡时间可提高分析精度。
11. 底物溶液保存过程中应无色，加入到酶标板中之后底物溶液应从无色变为渐变蓝色。
12. 终止液应按照与加底物溶液 (TMB) 相同的顺序添加到酶标板中。添加终止液后，孔中溶液的颜色将从蓝色变为黄色。绿色的孔表明终止液未与底物溶液充分混合，应轻拍孔板使其混匀。

疑难解答

问题	可能原因	解决措施
标曲线性不好	标准品稀释不正确	确保标准品按照推荐方法溶解和稀释
	移液不准确	定期校准移液器并检查枪头密封性
	反应液蒸发	用封板膜密封酶标板
	洗板不彻底	足够的洗涤次数和加入足量洗涤液
	孔底有异物	读数前清洁板底
显色弱或无	试剂反应不充分	确保孵育时间并按推荐温度孵育
	试剂体积添加不足	检查移液器并严格按照操作步骤操作
	稀释不正确	检查试剂稀释步骤
	酶结合物失活	混合酶结合物和底物，通过显色反应检查
OD 值低	酶标仪设置不正确	检查仪器波长
	没加终止液	加入适量终止液
	读板时等待时间太长	及时读板
背景高	显色液被污染	更换显色液
	显色时间太长	控制显色时间
	反应试剂稀释错误	使用推荐稀释方法
	洗板不彻底	足够的洗涤次数和加入足量洗涤液

相关产品：

PMK1323 人血管内皮生长因子 (VEGF) ELISA 试剂盒
PMK1314 人脑源性神经营养因子 (BDNF) ELISA 试剂盒
PMK1330 人生长分化因子 15 (GDF15) ELISA 试剂盒
PMK1320 人胰岛素样生长因子 1 (IGF-1) ELISA 试剂盒

更多产品详情了解，请关注公众号：

